



1

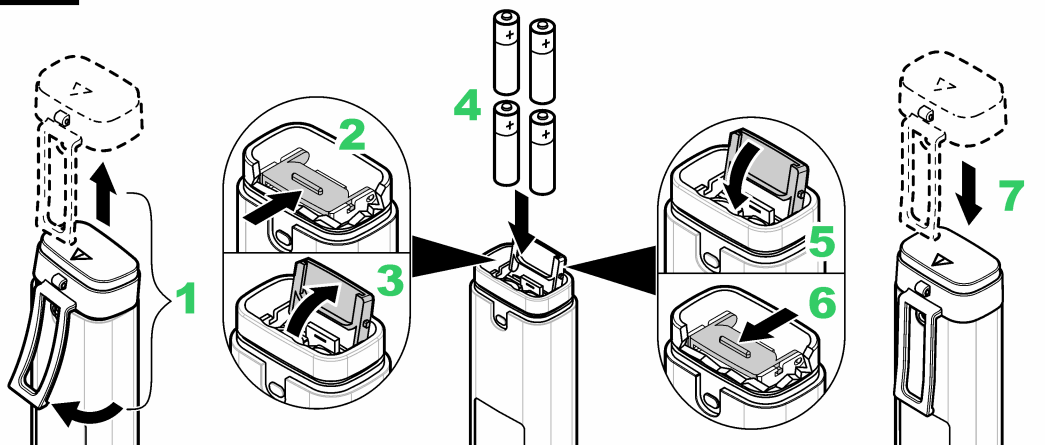

2

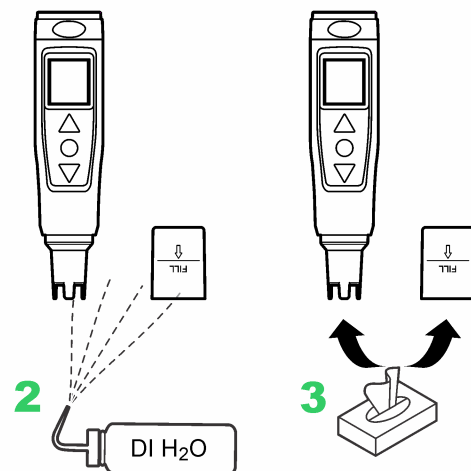


1

2

3



4

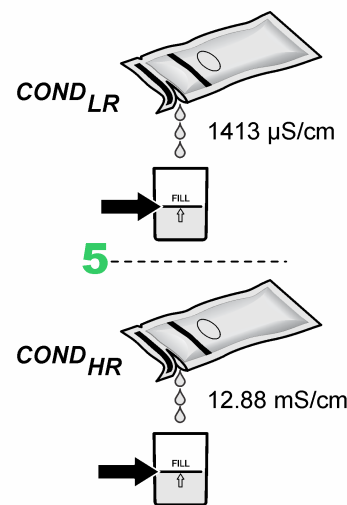

5




6

7




8



9

3

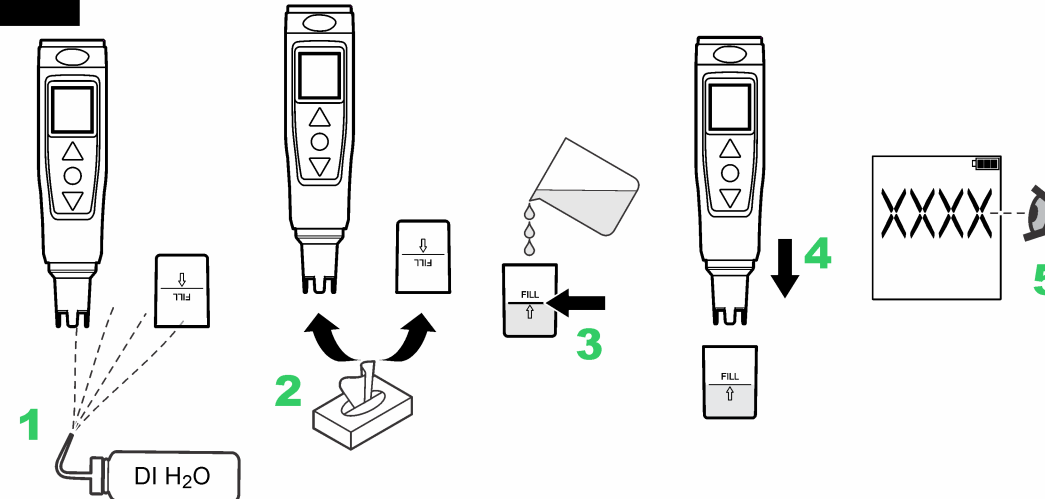

1


2

3

4

5

4

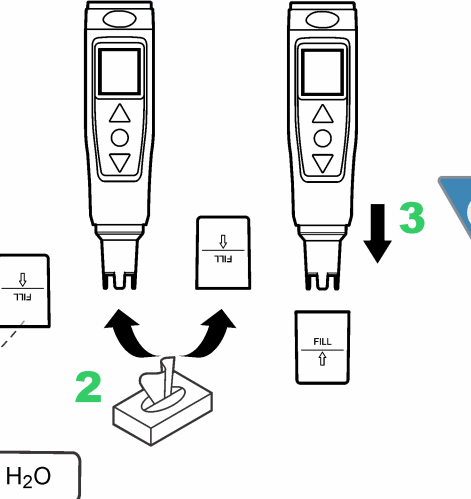

1

2

3

4

Pocket Pro Cond

Additional information is available on the manufacturer's website.

Warning

⚠ **Explosion hazard.** Incorrect battery installation can cause the release of explosive gases. Be sure that the batteries are of the same approved chemical type and are inserted in the correct orientation. Do not mix new and used batteries.

⚠ **Fire hazard.** Battery substitution is not permitted. Use only alkaline batteries.

Caution

⚠ **Chemical exposure hazard.** Refer to the current material safety data sheets (MSDS) for safety protocols.

Introduction

This conductivity tester is for use in general water samples.

Keys

	Push to stop changes to the display.
	Push to do a calibration. Push and hold until "SEt" flashes to go to the settings menu. Then, push to scroll through settings.
	To exit, push and hold.

2 Calibration

For Cond_{LR}: for 2-point calibration, do calibration two times with different standards.

3 Measurement

For best results, use the sensor cap.

Caution

⚠ **Air bubbles under the sensor tip can cause slow stabilization or error in measurement.** Gently shake the tester until bubbles are removed.

4 Storage

Refer to the expanded user manual on the manufacturer's website.

Settings

Unit	Temperature unit shown
trEF	Correction reference temperature
tC	Temperature compensation factor (linear)
AOFF	Automatic off
rSEt	Set to the factory settings and default values

Warranty

1 year for manufacturing defects only. Damage from use is not covered.

Compliance

Refer to the expanded user manual on the manufacturer's website.

EN

Pocket Pro Cond

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web du fabricant.

Avertissement

⚠ **Risque d'explosion.** Une installation incorrecte des piles peut libérer des gaz explosifs. Veillez à ce que les piles soient du même type chimique homologué et qu'elles soient insérées dans le bon sens. Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.

⚠ **Risque d'incendie.** La substitution du type de pile n'est pas autorisée. Utilisez uniquement des piles alcalines.

Attention

⚠ **Risque d'exposition chimique.** Reportez-vous aux fiches techniques de sécurité des matériaux (MSDS) pour connaître les protocoles de sécurité.

Introduction

Ce testeur de Conductivité s'utilise avec les échantillons d'eau courante.

Touches

	Appuyez pour arrêter les modifications à l'écran.
	Appuyer sur pour effectuer un étalonnage. Appuyez de manière prolongée jusqu'à ce que « SEt » clignote pour accéder au menu des paramètres. Ensuite, appuyez pour parcourir les paramètres.
	Pour quitter, appuyez de manière prolongée.

2 Etalonnage

Pour Cond_{LR} : pour l'étalonnage en 2 points, effectuez l'opération deux fois avec des étalons différents.

3 Mesure

Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez le bouchon du capteur.

Attention

⚠ **La présence de bulles d'air en dessous de la pointe du capteur peut entraîner une lenteur de la stabilisation ou une erreur de mesure.** Remuez doucement le testeur de manière à éliminer les bulles.

4 Stockage

Consultez le manuel d'utilisateur complet sur le site Web du fabricant.

Paramètres

Unit	Unité de température indiquée
trEF	Température de référence pour la correction
tC	Facteur de compensation de la température (linéaire)
AOFF	Arrêt automatique
rSEt	Permet de définir les paramètres d'usine et les valeurs par défaut

Garantie

Un an, uniquement pour les défauts de fabrication. Les dommages liés à l'utilisation ne sont pas couverts.

Conformité

Consultez le manuel d'utilisation complet sur le site Web du fabricant.

FR

Pocket Pro Cond

En el sitio web del fabricante encontrará información adicional.

Advertencia

⚠ **Peligro de explosión.** Si las pilas no están colocadas correctamente, se puede producir la liberación de gases explosivos. Asegúrese de que las pilas son del mismo tipo y material químico aprobado y están insertadas en el sentido correcto. No mezcle pilas nuevas y usadas.

⚠ **Peligro de incendio.** No se permite la sustitución de la batería. Utilice solamente baterías alcalinas.

Precaución

⚠ **Peligro por exposición química.** Consulte los protocolos de seguridad en las hojas de datos actuales de seguridad de los materiales (MSDS).

Introducción

Este comprobador de conductividad está diseñado para muestras de agua generales.

Teclas

	Pulse para detener los cambios en la pantalla.
	Pulse (Intro) para realizar una calibración. Pulse y mantenga pulsado hasta que aparezca el mensaje parpadeante "SEt" para ir al menú de configuración. Luego, pulse para navegar por la configuración.
	Para salir, pulse y mantenga pulsado.

2 Calibración

Para Cond_{LR} (Conductividad de rango bajo y total de sólidos disueltos de rango bajo): para realizar una calibración de dos puntos, realice la calibración dos veces con distintos patrones.

3 Medición

Para obtener resultados óptimos, utilice la tapa de la sonda.

Precaución

⚠ **Si se producen burbujas de aire bajo la punta de la sonda, se puede provocar una estabilización lenta o errores de medición.** Agite la sonda con suavidad hasta que las burbujas desaparezcan.

4 Almacenamiento

Consulte la versión ampliada del manual del usuario disponible en el sitio web del fabricante.

Configuraciones

Unit	Unidad de temperatura mostrada
trEF	Temperatura de referencia de corrección
tC	Factor de compensación de la temperatura (lineal)
AOFF	Apagado automático
rSEt	Restablecer los valores de fábrica y por defecto

Garantía

Sólo 1 año por los defectos de fabricación. No cubre los daños derivados del uso del producto.

Conformidad

Consulte la versión ampliada del manual del usuario disponible en la página web del fabricante.

ES